Slot No. 38 Sample ID 553 SupervisorID holam Lab Phone No. 13577 UserID m_cal

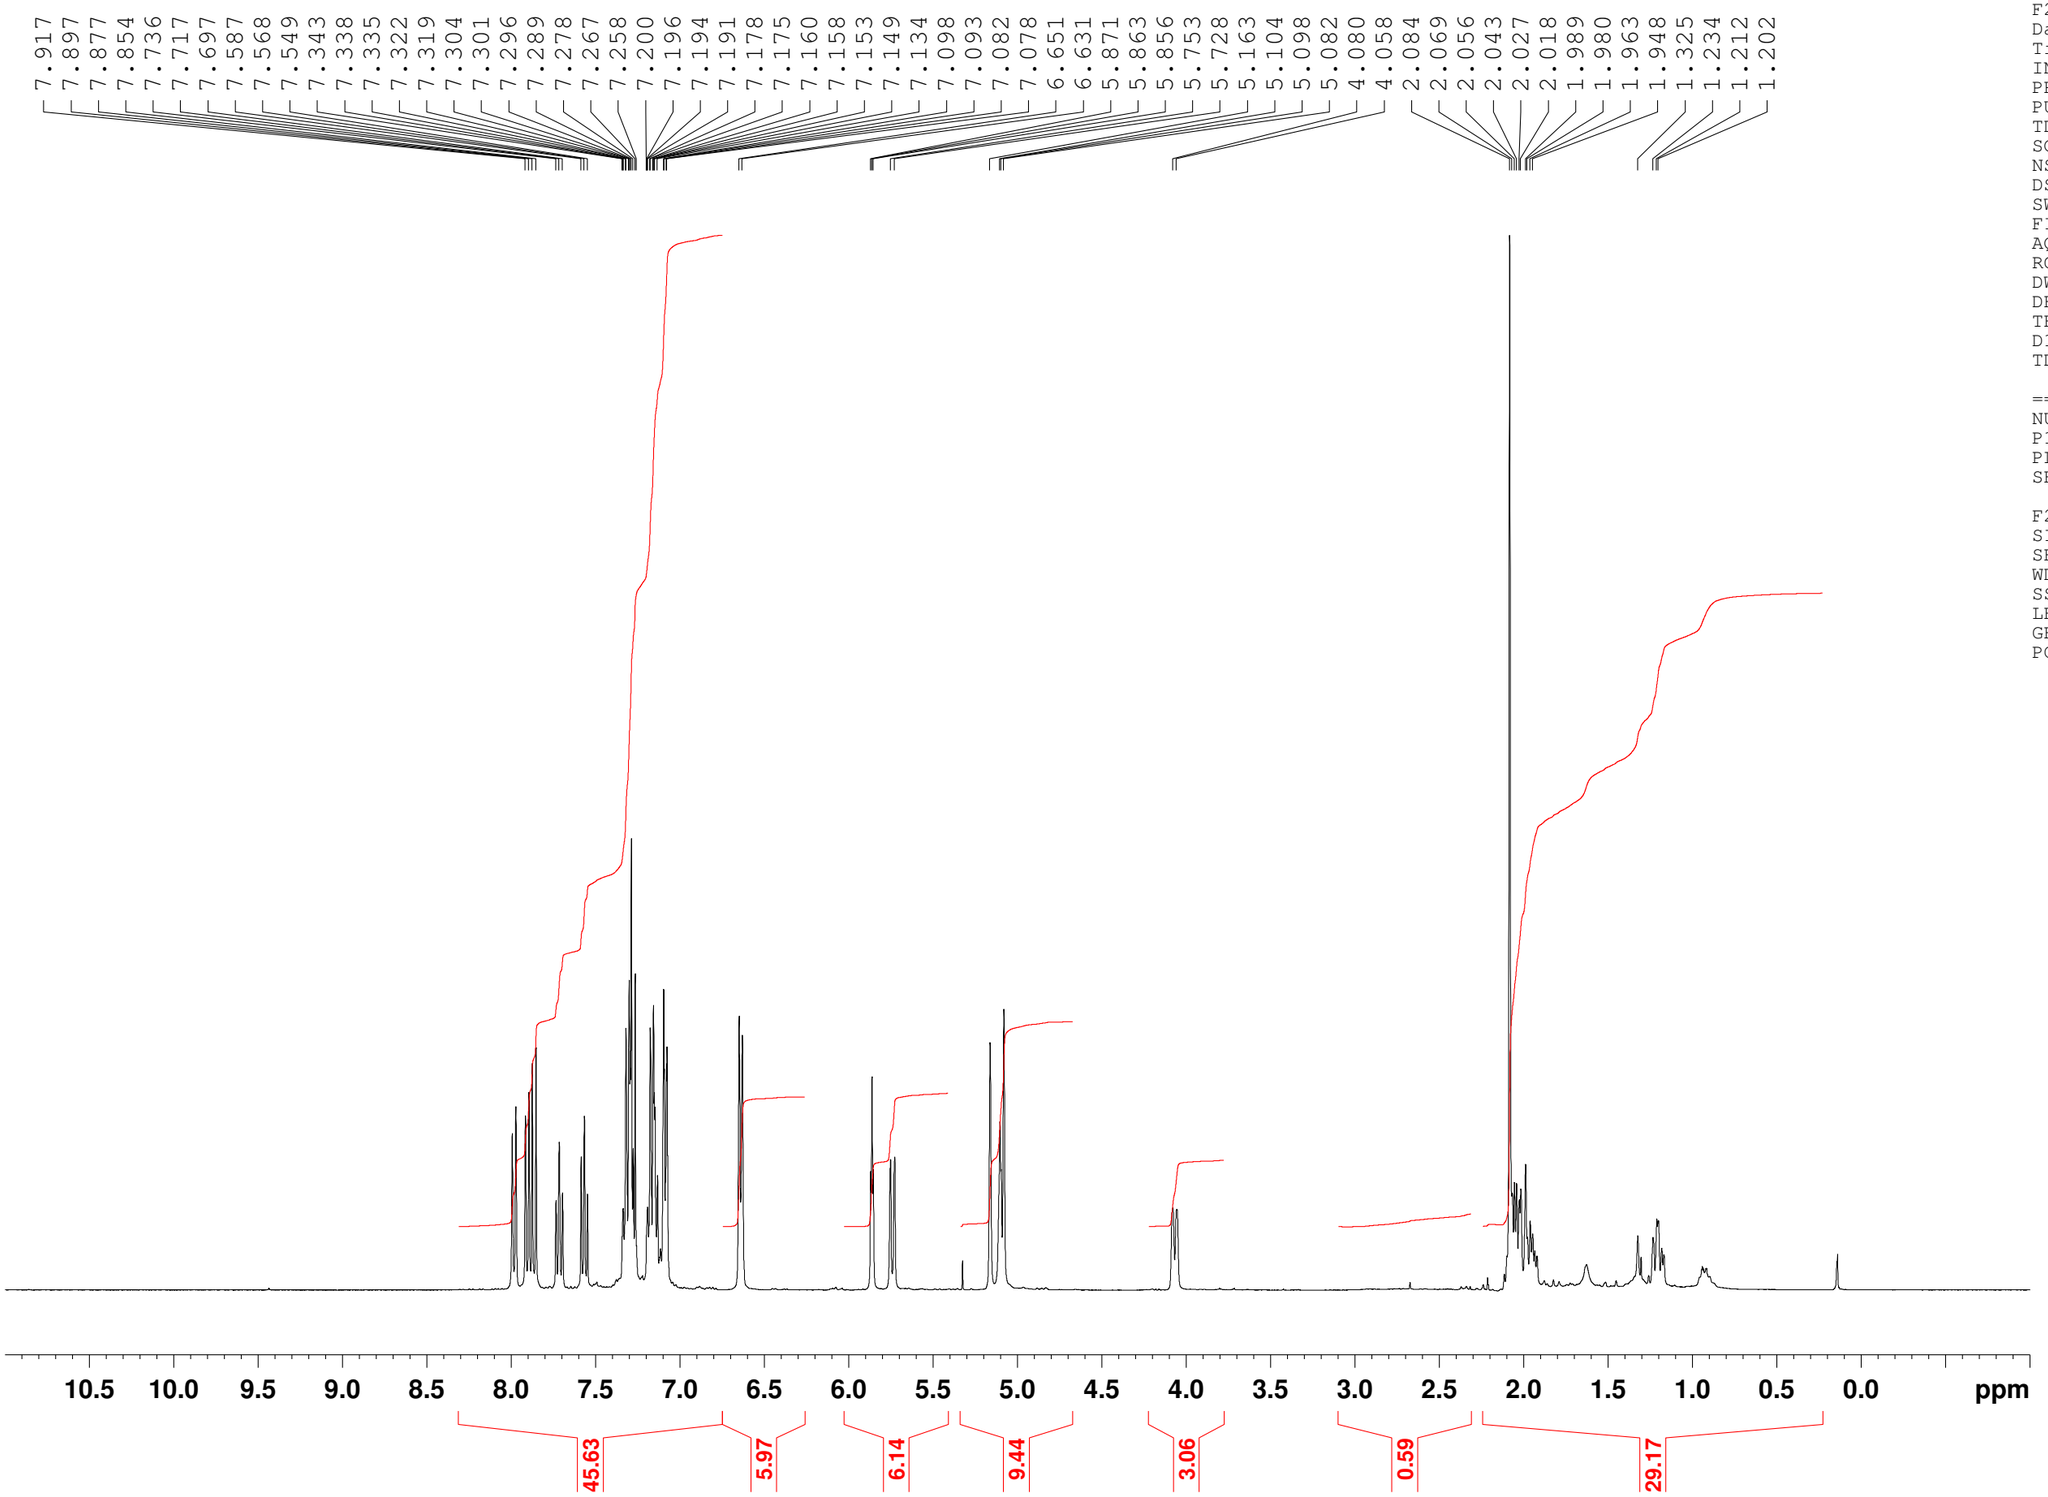


```
Current Data Parameters
NAME          m_cal.553
EXPNO                 1
PROCNO                1

F2 - Acquisition Parameters
Date_          20160126
Time              17.02
INSTRUM          dpx400
PROBHD   5 mm PABBO BB/
PULPROG            zg30
TD                65536
SOLVENT           CDCl3
NS                   16
DS                    2
SWH            8223.685 Hz
FIDRES         0.125483 Hz
AQ            3.9846387 sec
RG                  114
DW               60.800 usec
DE                 6.00 usec
TE                298.0 K
D1           1.00000000 sec
TD0                   1

======== CHANNEL f1 ========
NUC1                 1H
P1                13.40 usec
PL1               -6.00 dB
SFO1        400.2024712 MHz

F2 - Processing parameters
SI                65536
SF          400.2000000 MHz
WDW                  EM
SSB                   0
LB                 0.30 Hz
GB                    0
PC                 1.00
```